smiths medical

bringing technology to life

donner vie à la technologie

Système de drainage DRENTECH® Simple Plus

Procédure de mise en place

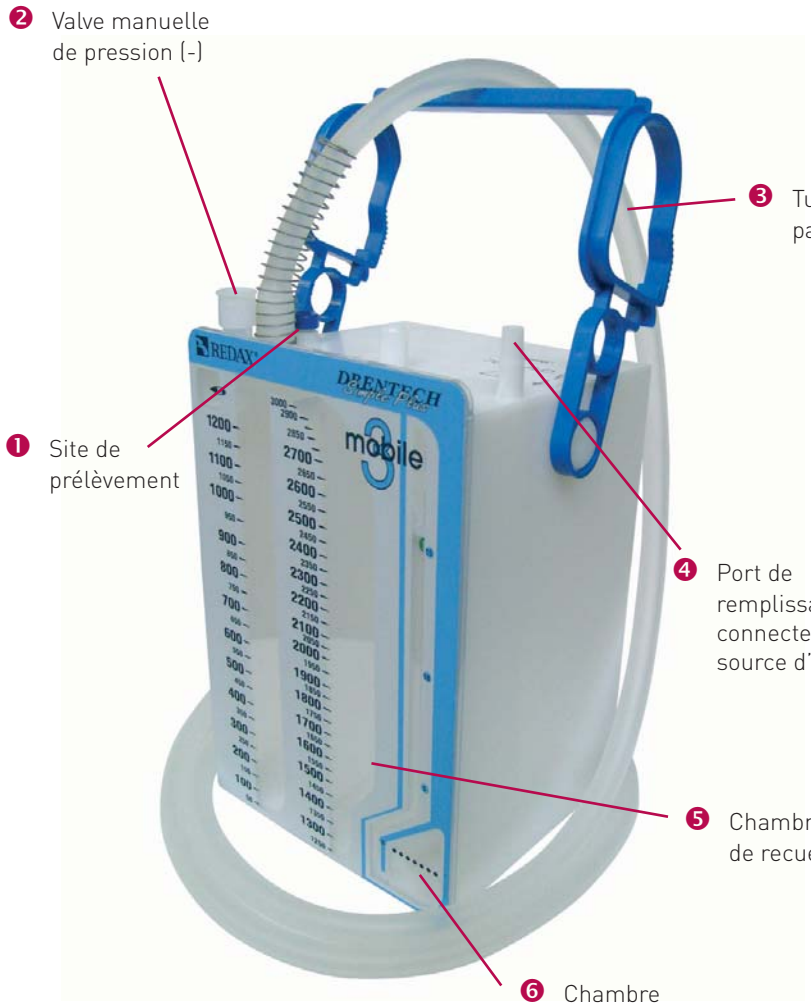
❷ Valve manuelle de pression (-)
❸ Tubulure patient
❶ Site de prélèvement
❹ Port de remplissage à connecter à la source d'aspiration
❺ Chambre de recueil
❻ Chambre de scellé sous eau

Désignation	Référence
Drentech® Simple Plus - mono chambre de recueil	10126PX

Mise en garde : Ce dispositif fonctionne aussi bien par gravité que par aspiration (à l'aide d'une source de vide). Attention : Ne pas brancher à la source de vide si celle-ci n'est pas équipée d'un manomètre de régulation.

1. Ôter le dispositif de son emballage en prenant soin de respecter les procédures d'asepsie.

2. Remplir d'eau stérile la chambre de scellé sous eau ❻ jusqu'aux pointillés horizontaux (environ 70 ml).

3. Connecter la tubulure patient ❸ au drain du patient. Le système est maintenant prêt à fonctionner par gravité.

4a. Pour une utilisation du système de drainage en aspiration, il est possible de connecter une source de vide murale ❹, à condition qu'elle soit munie d'un régulateur de vide (pression négative maximale conseillée -40 cm H2O sauf dans le cas où la valise est connectée avec une source d'aspiration Alto de la gamme 3 Mobile, prévue à cet effet) ❹.

4b. Il est possible de connecter une source d'aspiration portative Redax.

PURGE DE LA PRESSION NÉGATIVE EXCEDENTAIRE

En cas de pression négative excessive (indiquée par la hauteur de la colonne d'eau dans la chambre de scellé sous eau), presser la partie supérieure de la valve manuelle de pression négative ❷.
Une fois la compensation complète obtenue de la pression négative, relâcher la valve.

SITE DE PREVELEMENT

Il est possible d'effectuer des prélèvements au travers du site sécurisé ❶.

MISE EN GARDE

- Avant utilisation du dispositif, se rapporter au mode d'emploi fourni.
- Avant le transport du patient, déconnecter le système de la source de vide.
- Veiller à ce que l'unité de drainage soit toujours maintenue sous le niveau patient.
- Veiller à ce que la tubulure de drainage soit exempte de toute courbure ou plicature, afin d'éviter toute occlusion.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex
Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30
e-mail : morl.info@smiths-medical.com
www.smiths-medical.fr
Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Fabriqué par REDAX srl. - Mirandola ITALIE CE 0123

PORTEX™

CT196806FR-1211